

ForaCare® D20 No-Coding


Blood Glucose Plus Blood Pressure Monitoring System




Dear ForaCare D20 No-Coding System Owner:

Thank you for choosing ForaCare D20 No-Coding Blood Glucose Plus Blood Pressure Monitoring System to take control of your diabetes. Being a home care device, this system is helpful in tracking your blood glucose and blood pressure values.


The Quick Start User Guide will assist you in setting up the system and testing your blood glucose levels. Please read it carefully before use. For complete information on the system's use and features, please refer to the Owner's Manual.




Test Strip Vial



Test Strips




Lancets




Control Solution

Please note: Use only FORA D20 test strips with ForaCare D20 No-Coding System meter.



Clear Cap
(for obtaining blood from places other than your fingertip)

Lancing Device

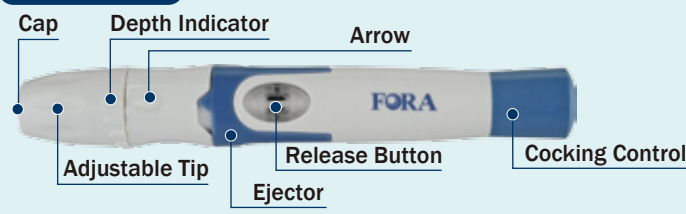

Lancing device, lancets and clear cap may not be included.
If your lancing device differs from the one shown here, please refer to the manufacturer's manual to ensure proper usage.

Please Note: Your lancing device may differ from the one shown in here.

Front View of Meter



- | | |
|-----------------|-------------------|
| ① Pressure Cuff | ⑥ DC Adapter Port |
| ② On/Off Button | ⑦ PC Link Port |
| ③ C Button | ⑧ Display Screen |
| ④ M Button | ⑨ S Button |
| ⑤ Test Slot | |

Rear View of Meter



- ⑩ Battery Compartment
- ⑪ Battery Cover

Quick Start User Guide

For self-testing. Read instructions before use. For *In vitro* diagnostic use.

Distributed by ForaCare

Fora Care Inc.
893 Patriot Dr., Suite D, Moorpark, CA 93021

Products made in Taiwan

Toll Free:

1-888-307-8188 (8:30am-5:00pm PST, Mon.-Fri.)

1-866-469-2632 (24 Hours, 7 days/week)

www.foracare.com

315-3263100-011

1. Setting the Monitor



Press **S** to start setting. Year flashes first.



Press **M** to change values. Hold down **M** to increase the number more quickly. Press **S** to move on to the next step.

1. Setting the Monitor




Date flashes. Follow **1.2** to make changes. The sequence of settings is:

- | | |
|----------------------------|---|
| (1) date | (4) memory deletion |
| (2) time | (5) voice volume |
| (3) unit of blood pressure | (6) language (L1: English, L2: Spanish) |

The meter will automatically turn off when the setting is complete. For memory deletion, please refer to the Owner's Manual for details.


2. Setting the Lancing Device



Twist and pull off the cap of the lancing device.



Insert a lancet into the lancet holder and push down firmly until it is fully secured.



Twist the protective disk off the lancet.



Replace and twist the cap to the right to close the lock as shown in the picture until you hear the click. When the lock is properly closed lock indicator is in the extreme right position.

2. Set the Lancing Device



Holding the cap select on the depth of penetration by turning the adjustable tip in either direction so that the arrow on the cap points to the desired depth.



Pull the cocking control back until it clicks. You will see a color change inside the release button when it is ready.

► If it does not click, the device may have been cocked when the lancet was inserted.

3. Testing Your Blood Glucose



Tear off the security label (Tamper Seal). When opening the vial for the first time, record the date on the label.



Wash and dry your hands thoroughly. Take a test strip out and then close the vial tightly.




Insert a test strip to turn on the monitor. The sequences of LCD display are: “ → flashing “” with date and time.




Take the pre-set lancing device. Hold the lancing device firmly against the puncture site. Press the release button to obtain a drop of blood.

3. Testing Your Blood Glucose




Gently squeeze around the punctured area to obtain enough blood.



While “” is flashing on the display, hold and touch the absorbent hole of the test strip to the drop of blood until the confirmation window is completely filled.



After the monitor counts down to 0, your test result will appear along with the date and time and will be automatically stored in the memory.



Remove the used test strip. Dispose of the used strip and lancet carefully.

For testing with control solution, please refer to the Owner's Manual for detailed information.

4. Reading Your Result

Your result will display the following messages:

Appears	When glucose
Lo	< 20 mg/dL (1.1 mmol/L)
KETONE?	≥ 240 mg/dL (13.3 mmol/L)
Hi	> 600 mg/dL (33.3 mmol/L)

Reference values for blood glucose:

Time of day	Normal plasma glucose range for people without diabetes
Fasting and before meal	< 100 mg/dL (5.6 mmol/L)
2 hours after meals	< 140 mg/dL (7.8 mmol/L)

Source:

American Diabetes Association (2012). Diabetes Care, 35 (Suppl 1): S64-71.

Please work with your doctor to determine a target range that works best for you.

5. Testing Your Blood Pressure



Sit down for at least 10 minutes before measuring.



Stretch your left arm forward with your palm facing up. Slide the cuff onto your left arm, above your elbow. The red line on the edge of the cuff should be approximately 0.8 to 1.2 inch (2 to 3 cm) above your elbow.




Arrange tubing over the main arteries inside of your arm. Press .




Relax and make sure the cuff is at the same height as your heart.

5. Testing Your Blood Pressure



Measurement is in progress: Start inflation → Stop inflation when cuff pressure is enough → Cuff pressure deflates steadily



The monitor will display the systolic pressure, diastolic pressure, and heart rate along with the date and time. Press to switch off.

ForaCare® D20 No-Coding

Sistema de Vigilancia de Glucosa y Medidor de Presión Arterial




Estimado Usuario del Sistema ForaCare D20 No-Coding:

Gracias por adquirir el Sistema de Vigilancia de Glucosa y Medidor de Presión Arterial ForaCare D20 No-Coding para controlar su diabetes. Al ser un aparato para ser utilizado en el hogar, este sistema le ayudará a vigilar sus niveles de glucosa en la sangre así como su presión arterial.

La Guía de Referencia Rápida le asistirá para programar su sistema y examinar los niveles de glucosa en la sangre. Para obtener la información completa sobre este sistema y sus características, por favor revise el manual del usuario.



El Dispositivo de Punción



El dispositivo de punción, las lancetas, la casquillo claro podrían no estar incluidas en su equipo.


Si su dispositivo de punción difiere del mostrado aquí, por favor diríjase al Manual del Usuario para asegurarse de hacer el uso debido del mismo. Por favor note: El dispositivo de punción puede diferenciar.

Vista Frontal del Medidor



- ① Banda de Presión
- ② Botón de On/Off
- ③ Botón de C
- ④ Botón M
- ⑤ Ranura de Prueba
- ⑥ Puerto para el Adaptador de Corriente Alterna
- ⑦ Puerto para Enlace de su Computadora Personal
- ⑧ Visualización de Pantalla
- ⑨ Botón S

Vista de la Parte Trasera del Medidor



- ⑩ Compartimiento de la Batería
- ⑪ Covertor de la Batería

Guía de Referencia Rápida

Para autoanálisis. Lea las instrucciones antes de utilizarse. Para uso diagnóstico *in vitro*.

Distribuido por ForaCare

Fora Care Inc.
893 Patriot Dr., Suite D, Moorpark, CA 93021

Productos hecho en Taiwan

Número de Teléfono Gratuito:

1-888-307-8188 (8:30am-5:00pm N, Lunes a Viernes)

1-866-469-2632 (24 Horas, 7 Días a la semana)

www.foracare.com

315-3263100-012

1. Programando el Medidor



Presione **S** para comenzar la programación. La luz del año parpadeará primero.



Presione **M** para cambiar los valores. Presione **M** para aumentar los número más rápidamente. Presione **S** (Programación) para seguir con el próximo paso.

1. Programando el Medidor




La Fecha se iluminará. Siga **1.2** Para hacer los cambios. La secuencia para la programación será:

- (1) Fecha
- (2) Hora
- (3) Unidad de medida de la presión
- (4) Borrado de Memoria
- (5) Volumen de la voz
- (6) Lenguaje (L1: Inglés, L2: Español)

El medidor se apagará automáticamente cuando la programación esté completa. Para borrar la memoria, por favor revise el Manual del Usuario para obtener mayores detalles.


2. Preparando el Dispositivo de Punción



Gire y destape el casquillo o tapa del dispositivo de punción.



Inserte una lanceta dentro orificio del dispositivo y empújela firmemente hacia abajo hasta que entre completamente en su lugar.



Twist the protective disk off the lancet.



Replace and twist the cap to the right to close the lock as shown in the picture until you hear the click. When the lock is properly closed lock indicator is in the extreme right position.

2. Preparando el Dispositivo de Punción



Sujetando el tapón, seleccione la profundidad de la penetración girando la punta ajustable en cualquier dirección de modo que la flecha del tapón señale la profundidad deseada.



Deslice el control de expulsión hasta que haga un "clic". Verá que el color en el botón de liberación cambiará cuando está listo.
► Si no hace un clic, es posible que el dispositivo de punción fuera montado cuando la lanceta fue insertada.

3. Haciendo una Prueba de Glucosa en la Sangre



Desprenda el sello de seguridad (Sellado para certificar su autenticidad) Al abrir el frasco de las tiras por primera vez, escriba la fecha en el envase.



Lávese y séquese bien las manos. Saque una tira reactiva y asegúrese de cerrar bien el envase.




Inserte una tira reactiva para encender su monitor. La secuencia que aparecerá en el LCD será: " " parpadeando " " con la fecha y la hora.




Tome el dispositivo de punción preparado anteriormente. Sostenga el dispositivo firmemente contra el lugar de punción. Presione y libere el botón para obtener una gota de sangre.

3. Haciendo una Prueba de Glucosa en la Sangre



Gentilmente apriete el área alrededor del lugar de punción para obtener suficiente sangre.



Mientras " " esté parpadeando en pantalla, aplique la gota de sangre en el canal absorbente de la tira reactiva hasta que la ventana de confirmación esté completamente llena.



El medidor contará de manera regresiva hasta 0, el resultado aparecerá junto con la fecha y la hora; y será almacenado automáticamente en memoria.



Saque la tira reactiva usada. Descarte la tira y la lanceta con mucho cuidado.

Para hacer una prueba con la solución de control, por favor diríjase al Manual del Usuario para obtener mayor información.

4. Leyendo sus Resultados

Su resultado mostrará los siguientes mensajes:

Aparecerá	Cuando la glucosa
Lo	< 20 mg/dL (1.1 mmol/L)
KETONE?	≥ 240 mg/dL (13.3 mmol/L)
Hi	> 600 mg/dL (33.3 mmol/L)

Referencias del valor de la glucosa en la sangre:

Hora del día	Rango normal para el plasma en la glucosa para personas sin diabetes
En ayuno o antes de la comida	< 100 mg/dL (5.6 mmol/L)
2 horas después de la comida	< 140 mg/dL (7.8 mmol/L)

Fuente:

Asociación Americana contra la Diabetes. (2012) Recomendaciones Prácticas Clínicas. Cuidados de Diabetes, 35 (Suplemento 1): S64-71.

Por favor consulte con su doctor para determinar cual es el rango meta que más conveniente para usted.

5. Haciendo una Prueba de la Presión Arterial



Siéntese al menos 10 minutos antes de realizar la medición.



Estire su brazo izquierdo con la palma hacia arriba. Deslice la banda de presión en su brazo izquierdo, un poco más arriba del codo. La línea roja en el borde de la banda de presión debe estar aproximadamente de 0.8 a 1.2 pulgadas (de 2 a 3 cm) más arriba de su codo.




Arregle los tubos de aire para que queden encima de las principales arterias de su brazo. Presione .




Relájese y asegúrese de que la banda esté a la misma altura que su corazón.

5. Haciendo una Prueba de la Presión Arterial



Medición en progreso: Inicio de inflado → Cuando la banda de presión tiene suficiente aire se detendrá → La banda de presión se desinflará continuamente



El monitor mostrará la presión sistólica, la presión diastólica y el pulso así como la fecha y la hora. Presione para apagarlo.